



MANUAL SJÄLVTEST THYRO-Check® Självtest

SV

quicktest.se

Avläs resultat

Styrka, färg eller intensitet i testfönstret har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat. **T** och **C** är förkortningar för **T** (Test) och **C** (Control).

1. Negativt resultat

Endast en färgad linje framträder under C. Detta betyder att din TSH-nivå är normal.



2. Positivt resultat

Två färgade linjer framträder i testfönstret under T och C. Notera att intensiteten under T kan vara tydligare än under C. Detta betyder att dina TSH-nivåer är förhöjda eller högre än normalt. Du bör kontakta läkare.



3. Misslyckat resultat

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en linje under T så är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och kan inte återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt test utförs.



Frågor och svar

Hur fungerar testet?

Detta självtest indikerar förhöjda nivåer av hormonet TSH. Förhöjda nivåer behöver inte betyda att du är allvarligt sjuk utan det kan bero på en del olika tillstånd. Därför är det viktigt att uppsöka en läkare vid ett positivt resultat.

Kan resultatet vara felaktigt?

Resultatet är korrekt om instruktionerna har följts. Resultatet kan vara felaktigt om testet har blivit utsatt för fukt eller om blodet har blivit kontaminerat. För mycket eller otillräcklig blodmängd kan ge felaktigt resultat. Pipetten är designad för att garantera att rätt mängd blod används.

Har linjernas intensitet i testfönstret någon betydelse?

Styrka, färg eller intensitet i kontrollstrecket har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat. Om du kan urkölja en linje ska detta tolkas som en linje.

Vad betyder linjen under markeringen C?

Det betyder att självtestet fungerar normalt.

Kommer testet att vara tillförlitligt om jag avläser testet efter 15 minuter?

Nej. Testet ska avläsas inom 10 minuter efter utspädningsvätskan har droppats i testhålet. Efter 15 minuter är testet inte tillförlitligt och bör kastas.

THYRO-Check® Kotitesti

Ref. 21084BI

Kotitesti, joka havaitsee kilpirauhasen vajaatoiminnan.

YLEISESTI

Kilpirauhasen toiminnan häiriö on yleinen vaiva etenkin naisilla. Kilpirauhasen vajaatoiminnasta (hypotyreosi) kärsivien määrä on kasvussa. Oireita ovat muun muassa väsymys, kalpeus, painonrousus, ihmikuivuus, huisten huono kunto, hajameliisuus, masennus, palelu sekä kuukautisten epäsäännöllisyys tai loppuminen.


Testi on positivinen, kun TSH-taso on yli 5 µIU/ml.

Huom - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

1. Testireikä
2. Tulosikuna
3. Pipetti
4. Harmaa kupu
5. Laukaisin
6. Sininen korkku
7. Valkoinen korkku
8. Laimennusneste

Sisältö:

- 1 alumiinipakaus, joka sisältää:
 - 1 kpl Jossa on testikasetti
 - 1 kpl Pipetti
 - 1 kpl Sekä kuivausainetta (ei käytöön).
- Aava pussi vasta, kun olet valmis tekemään testin.
- 1 kpl sterili lansetti (+ ylimääräinen)
- 1 kpl 1 ml pullo, jossa on laimennusainetta
- 1 kpl käytööhjhe



Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten testi toimii?

Tämä kotitesti havaitsee kohonneet TSH-hormoniarvot. Yli 5 µIU/ml TSH- arvo merkitsee kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Voiko tulos olla virheellinen?

Tulos on oikea, jos testi on tehty ohjeita noudattaen. Tulos voi olla virheellinen, jos testi on altistunut kosteudelle tai veri on kontaminointuun. Myös liian suuri tai vähäinen verimäärä voi vaikuttaa tuloksen luotettavuuteen. Pipettiin on merkity verimäärä, jota testissä tulee käyttää.

Onko tuloskunhan viivojen vahvuudella merkitystä testitulokseen?

Viivojen värillä tai intensiteetillä ei ole vaikuttusta tai merkitystä tulokseen. Jos voit erottaa viivan, se tulkitaan viivaksi.

Mitä C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa?

C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa, että testi toimii normaalista.

Voiko testitulokseen luottaa, jos tarkistan sen 15 minuutin kuluttua?

Ei. Testitulos tulee tarkistaa 10 minuutin kuluttua siitä, kun liuos on laitettu näyteaukkoon. 15 minuutin kuluttua testi ei ole enää luotettava ja se pitää hävittää.

Kontrollitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

Testitulos on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huoma, että värin intensiteetti voi olla erilaista T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että TSH-taso on tavallista korkeampi. Ota yhteystä lääkärin.

Testitulos on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että TSH-taso on normali.

</div



MANUAL SELVTEST THYRO-Check® Selvtest

NO

quicktest.no

Les av resultatet

Styrke, farge eller intensitet i testvinduet har ingen effekt eller betydning for å kunne avlese testresultater.
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Control).

1. Negativt resultat

Bare en farget linje vises under C. Det betyr at TSH-nivået ditt er normalt.



2. Positivt resultat

To farged linjer vises i testvinduet under T (Test) og C (Control). Legg merke til at intensiteten under T kan være tydeligere enn under C. Dette betyr at TSH-nivåene dine er forhøyde eller høyere enn normalt. Du bør konsultere en lege.



3. Misslykkat resultat

Dersom ingen linje vises, eller hvis bare en linje under T vises, har testen feilet og bør kasseres. Merk at selv-testen er forbukket og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales at en ny test utføres.



THYRO-Check® Selvtest

Ref. 21084BI
Selvtest som indikerer for underaktiv skjoldbruskkjertel.

GENERELT

Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen er en vanlig tilstand, særlig hos kvinner. Antallet som berørs av en underaktiv skjoldbruskkjertel (hypothyroidisme) øker. Symptomer på underaktiv skjoldbruskkjertel inkluderer tretthet, svakhet, vektorknin, torr hud, dårlig hårkvalitet, glemsomhet, depriemt, frysninger, forstoppelse og uregelmessige menstruasjonsperioder.

Testen viser positivt når TSH-nivået er høyere enn 5pIU/ml.

Merk - Les instruksjonene nøyne før bruk.

1. Testhull
2. Resultatvindu
3. Pipette
4. Grå hatt
5. Utlösar
6. Blå kork
7. Hvit kork
8. Fortynningsmiddel



Innhold:


- 1 aluminiumspose som inneholder:
- 1 stk Testkassett
- 1 stk Pipette for blodoppssamling
- 1 stk Tørkemiddel (brukes ej)

Åpne forpakningen når du er klar til å fullføre testen.

- 1 stk Steril lancett (+ en ekstra)
- 1 stk 1ml flaske med fortyning
- 1 stk Manual

Advarselsforskrifter og viktig informasjon

Dette er en in-vitro selvtest, kun for ekstern bruk. Skal ikke konsumeres. Les instruksjonene nøyne for bruk. Resultatet kan bare leses av når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruksjonene for håndtering, blodmengde og fortyning. Oppbevares mellom + 4°C til + 30°C. Må ikke fryses. Oppbevares tørt og beskyttet mot sollys. Skal ikke brukes etter utdøpsdato märket med et timglass på ytterforpakningen og aluminiumsforpakningen. Testen skal ikke brukes dersom aluminiumspakken er åpenet. Selvtesten skal ikke gjenbrukes. Oppbevar produktet utilgängelig for barn og dyr. Ytteremballasje sorteres som kartong/papir. Øvrige skal sorteres som restavfall.

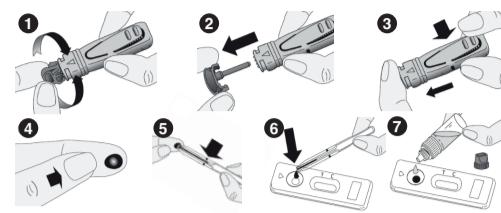

SLIK GJØR DU:

1. Vask hendene grundig med såpe og vann. Tørk hendene.
2. Forbered for å gjennomføre testen: Fjern testkassetten og pipetten ut av aluminiumsposen og plasser testkassetten flatt innenfor rekkevidde. (Tørkemidlet skal ikke brukes).
3. Klarlegg lansetten. Dette gjøres ved å vr i den grå delen (bilde 1) av lansetten 2-3 omdreininger indtill den løsner HELT, og derefter trekke den grå delen rett ut (bilde 2), uten å trykke på utlösarknappen.
4. Masser valgt fingeropp med de rengjorte fingrene.
5. Trykk lansetten BESTEMT mot fingeren og trykk på utlösarknappen. (Nålen trekkes automatisk inn i lansetten).

6. Trykk HARDT på fingeren for å få en dråpe blod.
7. Pipetten plasseres mot bloddråpen, et undertrykk gjør det mulig for blodet å suges opp. La bare den mengde blod som kreves fylles opp til markeringen (linjen) på pipetten. Hvis mer blod er nødvendig, masser fingeren igjen. Prov å unngå å få luftbobler i pipetten. Merk at dette trinnet kan ta opptil 2 minutter å fullføre.
8. Press ut blodet fra pipetten inn i testhullet (det runde hullet) ved å trykke på pipetten.
9. Hvis du ikke lykkes med å la blodet strømme inn i pipetten - gjør følgende: Legg pipetten fra deg, fortsett å massere fingeren hardt til det har dannet seg en dråpe - hvis mulig; la dråpen falle fritt ned i testhullet. Hvis dråpen ikke vil forlate fingeren; La dråpen berøre testhullet og renne ut.
10. Vent 30 sekunder for å tillate blodet og absorbere i testhullet. Skru av det blå lokket på fortynningsvæskeren. Drypp deretter 4 dråper i testhullet med 2 sekunder mellom hver dråpe.
11. Les av resultatene etter 10 minutter. Tolk ikke resultatet etter 15 minutter.

Vil du se hvordan det går til?
Skann QR-koden med din mobiltelefon



quicktest..

THYRO-Check® Selvtest

Ref. 21084BI

Selvtest, som reagerer ved en for underaktiv skjoldbruskkjertel.

GENERELT

Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen er en almindelig tilstand, særligt hos kvinder. Antallet, som berørs av en underaktiv skjoldbruskkjertel (hypothyroidisme), øges. Symptomer på underaktiv skjoldbruskkjertel inkluderer træthed, svaghed, vægttagning, tor hud, dårlig hårkvalitet, glemsomhed, depression, kuldsærhed, forstoppelse og uregelmæssige menstruationsperioder.

Testen viser positivt, når TSH-niveauet er højere end 5pIU/ml.

Bemærk - Læs instruksionerne nøyne før bruk.

1. Testhul
2. Provesvar
3. Pipette
4. Grå hætte
5. Udløser
6. Blå hætte
7. Hvid hætte
8. Fortyningssmidel



Innehold:


- 1 aluminiumspose, som indeholder:
- 1 stk testkassett
- 1 stk pipette for blodopsamling
- 1 stk Tørningsmidel (anvendes ej)

Abn pakken, når du er klar til at udføre testen.

- 1 steril lancet (+ en ekstra)
- 1 1ml flaske med fortyning
- 1 manual

Advarselsforskrifter og viktig information

Dette er en in-vitro selvtest, kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Læs instruksionerne nøyne for anvendelse. Resultatet kan kun aflæses, når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruktioner for håndtering, blodmængde og fortyning. Opbevares mellem + 4°C til + 30°C. Må ikke fryses. Opbevares tørt og beskyttet mod sollys. Må ikke anvendes efter utdøpsdato märket med et timglass på yderpakningen og aluminiumspakningen. Testen må ikke bruges, hvis aluminiumspakken har været åben. Selvtesten skal ikke gjenbrukes. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr. Yderemballage sorteres som karton/papir. Øvrige affald skal sorteres som restaffald.

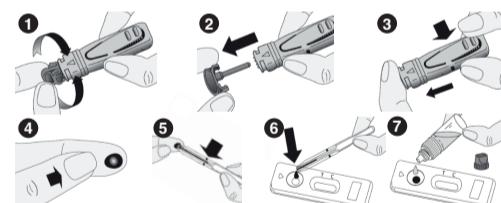

SÅDAN GØR DU:

1. Vask hænderne med sæbe og vand. Skyg og tor hænderne grundigt.
2. Tag testkassetten og pipetten ud af aluminiumsposen og placér testkassetten plant indenfor rækkevidde. (Tørningsmidlet skal ikke bruges).
3. Klargør lancetten. Dette gøres ved at dreje den grå del (billede 1) af lancetten 2-3 omgange, indtil den løsner sig HELT, og derefter trække den grå del lige ud (billede 2), uden at trykke på udlösarknappen.
4. Masser den valgte fingerspids med de rengjorte fingrene.
5. Tryk lancetten HARDET mod din finger, og tryk på udlösarknappen. (Nålen trækkes automatisk ind i lancetten).

MANUAL SELVTEST THYRO-Check® Selvtest

DK

quicktest.dk

Aflæs resultatet

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultater. T og C er forkortelser for T (Test) og C (Kontrol).

1. Negativt resultat

Kun en enkelt farvet linje vises under C. Det betyder, at dit TSH niveau er normalt.



2. Positivt resultat

To farged linjer vises i testvinduet under T (Test) og C (Control). Læg mærke til, at intensiteten under T kan være tydeligere enn under C. Dette betyder, at dine TSH-niveauer er forhøyde eller høyere end normalt. Du bør konsultere en læge.



3. Mislykket resultat

Hvis der ikke fremkommer en linje, eller hvis der kun vises en enkelt linje under T, er testen forbrukt og bør kasseres. Bemærk, at selvtesten er opbrugt og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales, at der udføres en ny test.



Spørsmål og svar

Hvordan virker Quicktest skjoldbruskkjertel selvtest?

Denne selvtesten indikerer forhøjede niveauer af hormonet TSH. Et TSH- niveau over 5 pIU /mL indikerer en underaktiv skjoldbruskkjertel.

Kan resultatet blive forkert?

Resultatet er rigtigt, hvis instruksionerne er fulgt. Resultatet kan være forkert, hvis testen er blevet utsat for fugt, eller hvis blodet er blevet kontamineret. For meget eller en ulstrækkelig blodmængde kan også medvirke til et forkert resultat. Pipetten er udformet, så den sikrer, at den rette mængde blod bliver brugt.

Har linjernes intensitet i testvinduet nogen betydning?

Kontrolstregens styrke, farve eller intensitet har ingen effekt eller betydning for aflæsning af testresultaterne. Hvis du kan skelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

Hvad betyder linjen under markeringen C (Control)?

Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

Vil testen være pålitelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minutter? Nej. Testen skal aflæses indenfor 10 minutter efter at fortyningssmidlet er blevet dryppet ned i testhullet. Efter 15 minutter er testen ikke pålitelig og bør kasseres.

Spørsmål og svar

Hvad gør jeg, hvis testen er positiv?

Hvis testen er positiv, betyder det, at TSH niveauerne er højere end 5pIU/mL. Så skal du kontakte en læge og forklare, at du har foretaget en Quicktest skjoldbruskkjerteltest, og at resultatet var positivt. Lægen vil derefter foretage en videre undersøgelse.

Hvad gør jeg, hvis testen er negativ?

Hvis testen er negativ, betyder det, at TSH-niveauerne er lavere end 5pIU/mL. Hvis du mistænker sygdom eller har symptomer, må du kontakte din læge for videre undersøgelse.

Hvor pålitelig er testen?

Quicktest skjoldbruskkjertel selvtest betragtes som en yderst sikker selvtest. Den er blevet brugt i sundhedsvesenet i ca 10 år. Studier viser, at påliteligheden er på mindst 95,5%.



Du vidste, at vi også tilbyder selvtest inden for...



NYHED! Multiitest X6

Nu kan du teste kolesterol, laktagt (mælkesyre), ketonivåer (ketose), triglycerider og blodsukker – alt i samme instrument! Hver test har sin egen unikke teststrimmel, så du altid får præcise resultater.



CRP-Test

Vår unike og patenterede CRP-test gir deg svar på få minutter. Du gjør testen som alle andre tester; hjemme - du får svaret med en gang.



Levertest

Leveren er et af kroppens vigtigste organer. Hvis leveren ikke føles bra, kan mange funktionsstörslas ud. Ofte kommer leverproblemer snigende og mange mærker ikke af de første symptomer på at noe er galt. En levertest kan avklare hvordan leveren din har det.

Vil du se, hvordan det fungerer?

Scan QR-koden med din mobiltelefon



quicktest..

THYRO-Check® Selvtest

Ref. 21084BI

Selvtest,